


Produktbroschüre

10.08.2026

SAUTER CS 7500-3P1

4-Leiter "S"-Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung

DEUTSCH

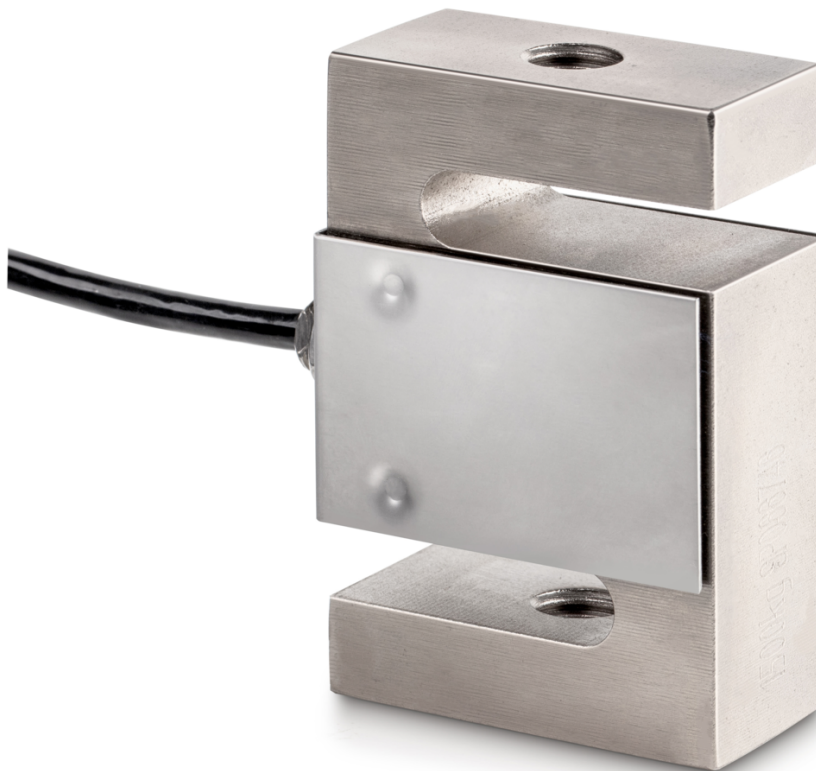

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen
- Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Maschinen- und Anlagenbau
- Prüftechnik und Materialprüfung
- Fördertechnik und Logistik
- Behälter- und Siloverwiegung
- Medizintechnik und Forschung

PIKTOGRAMME

Standard

Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Messbereich [Max]
CS 25-3P1	25 kg	250 N
CS 50-3P1	50 kg	500 N
CS 100-3P1	100 kg	1 kN
CS 150-3P1	150 kg	1,5 kN
CS 250-3P1	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P1	500 kg	5 kN
CS 600-3P1	600 kg	6 kN
CS 750-3P1	750 kg	7,5 kN
CS 1000-3P1	1000 kg	10 kN
CS 1500-3P1	1500 kg	15 kN
CS 2000-3P1	2000 kg	20 kN
CS 2500-3P1	2500 kg	25 kN
CS 5000-3P1	5000 kg	50 kN

Modell	Wägebereich [Max]	Messbereich [Max]
CS 7500-3P1	7500 kg	75 kN
CS 10000-3P1	10000 kg	100 kN
CS 15000-3P1	15000 kg	150 kN
CS 20000-3P1	20000 kg	200 kN
CS 30000-3P1	30000 kg	300 kN

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
CJ P2	Junctionbox CJ P2, Anschlussmöglichkeiten: 2, Aluminium,
CJ P4	Junctionbox CJ P4, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, IP65
CJ P4PG	Junctionbox CJ P4PG, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium,
CJ X467	Junctionbox CJ X467, Anschlussmöglichkeiten: 4, rostfreier Stahl, IP67
CJ X468	Junctionbox CJ X468, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, IP68
FS 407	Stecker für FS Messzelle montiert & justiert bis 120 kN FS 407
YKV-01	Digitaler Wägetransmitter YKV-01

DIENTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-166	Werkskalibrierschein 961-166 (Kraftrichtung Zug 51 kN – 120 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren KERN)
961-166V	Werkskalibrierschein 961-166V (Zug mV/V)
961-264V	Werkskalibrierschein 961-264V (Druck mV/V)
961-266	Werkskalibrierschein 961-266 (Kraftrichtung Druck 51 kN – 120 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren KERN)
961-266V	Werkskalibrierschein 961-266V (Druck mV/V)
961-366	Werkskalibrierschein 961-366 (Kraftrichtung Zug, Druck 51 kN – 120 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren KERN)
961-366V	Werkskalibrierschein 961-366V (Zug, Druck mV/V)
963-166	DAkKS-Kalibrierschein 963-166 (Kraftrichtung Zug 51 kN – 120 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 – Ablauf A)
963-266	DAkKS-Kalibrierschein 963-266 (Kraftrichtung Druck 51 kN – 120 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 – Ablauf A)

Modell	Beschreibung
963-366	DAkkS-Kalibrierschein 963-366 (Kraftrichtung Zug, Druck 51 kN – 120 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 – Ablauf A)
965-415	Zusammenbau Komponenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-101	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-101

KERN Piktogramm-Übersicht



Staub- und Spritzwasserschutz IP67



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage