

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 348-22

Milligrammgewichtssatz, M1, 1 mg - 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert, im Kunststoff-Etui


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

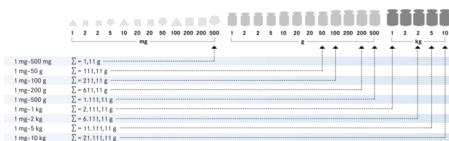

PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzetten 315-242 (Polyamid 100 mm)
315-247	Pinzetten 315-247 (Edelstahl, Kunststoff 136 mm)
317-009-600	Aluminium-Gewichtsetui 317-009-600 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M3 für Bauform Bruchgramm)
318-270	Pinzel 318-270
328-222-420	Gewichtsetui 328-222-420 (für Nennwerte 1 mg - 5 g für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)
338-090-200	Holz-Gewichtsetui 338-090-200 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)
347-009-400	Kunststoff-Gewichtsetui 347-009-400 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)
348-01	Prüfgewicht 348-01 (OIML-Klasse M1, Nennwert 1 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
348-02	Prüfgewicht 348-02 (OIML-Klasse M1, Nennwert 2 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
348-03	Prüfgewicht 348-03 (OIML-Klasse M1, Nennwert 5 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
348-04	Prüfgewicht 348-04 (OIML-Klasse M1, Nennwert 10 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
348-05	Prüfgewicht 348-05 (OIML-Klasse M1, Nennwert 20 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
348-06	Prüfgewicht 348-06 (OIML-Klasse M1, Nennwert 50 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
348-07	Prüfgewicht 348-07 (OIML-Klasse M1, Nennwert 100 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
348-08	Prüfgewicht 348-08 (OIML-Klasse M1, Nennwert 200 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
348-09	Prüfgewicht 348-09 (OIML-Klasse M1, Nennwert 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)

DIENTSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-701	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-701
962-650	DAkS-Kalibrierschein 962-650
962-650R	DAkS-Rekalibrierung 962-650R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage